




Mess- & Analysensysteme Golombek GmbH

Betriebsanleitung für die Zusatzheizung ZH-1

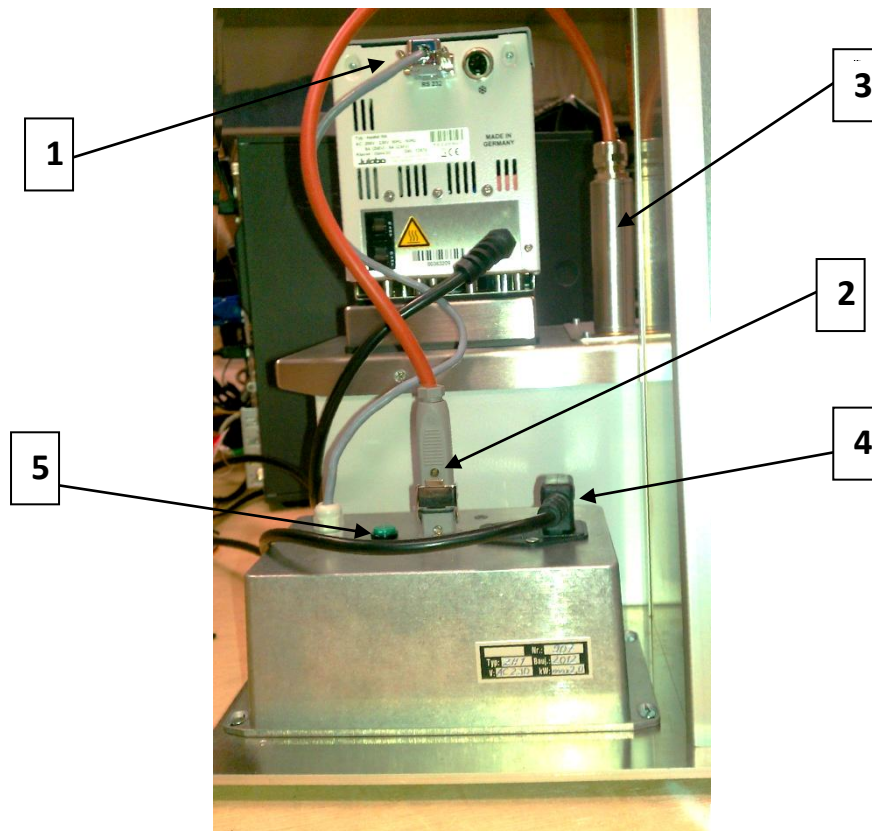

Zur Inbetriebnahme der Zusatzheizung mit dem Folienanalysegerät, verbinden Sie den 9 pol. Sub-D-Stecker ① mit der Buchse auf der Rückseite des MA-4 Temperiergeräts.

Verbinden Sie die Heizung ③ mit der Buchse ② auf dem Gehäuse der Zusatzheizung ZH-1. Die max. Leistung der Heizung darf 2000 Watt nicht überschreiten.

Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Einbaustecker ④ und einer Schutzkontaktsteckdose des Netzstroms. Stellen Sie sicher, dass der Netzstrom vorschriftsmäßig mit 230 V~50 Hz, geerdetem Nullleiter, einer 16 A Sicherung und einem FI-Schalter (Fehlerstromschutzschalter) ausgestattet ist!

Führen Sie die Montage, die Wartung und die Pflege des ZH-1 Zusatzheizung nur frei von Netzstrom durch!

Schalten Sie den Netzschalter neben dem Kaltgerätestecker ein. Die Zusatzheizung ist nun betriebsbereit und wird über das Temperiergerät gesteuert.

Die Kontrollampe ⑤ zeigt an, wenn die Zusatzheizung aktiv ist.

Die Temperatur, der Füllstand der Badflüssigkeit wird über das Temperiergerät überwacht und im Falle einer Störung auch die Zusatzheizung abgeschaltet.

Version 1.20 vom 26. März 2021, Jörg Golombek